

RS-UV-*-AL

铝壳紫外线变送器 使用说明 (模拟量型)

文档版本: V1.1





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。
4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



1.产品介绍	4
1.1 功能特点	4
1.2 技术指标	4
2.设备安装	5
2.1 安装前检查	5
2.2 安装方式	5
2.3 设备尺寸（单位：mm）	5
2.4 接线	6
3. 接线方式举例	6
4.计算方法	7
4.1 电流型输出信号转换计算	7
4.2 电压型输出信号转换计算	7
5.常见问题及解决办法	7
6.注意事项	7
7. 质保声明	8
8..联系方式	8
9.文档历史	8



1.产品介绍

RS-UV-*-AL 是我公司研发的一款紫外线变送器。本产品基于光敏元件将紫外线转换为可测量的电信号原理,实现紫外线的在线监测。电路采用进口工业级微处理器芯片、进口高精度紫外线传感器,确保产品优异的可靠性、高精度。产品外壳为高防护等级外壳,防护等级 IP67,防雨雪。

本产品可以广泛应用在环境监测、气象监测、农业、林业等环境中。测量大气中以及人造光源等环境下的紫外线。

1.1 功能特点

- 采用对 290-390 nm 高敏感的紫外线测量器件,精准测量紫外线强度。
- 高品质透光材料,紫外线透过高
- 4-20mA/0-10V/0-5V 多种模拟量输出信号可选。
- 防护等级高,适用环境广

1.2 技术指标

直流供电 (默认)	10-30VDC (0~10V 型产品只能 DC 24V 供电)	
最大功耗	0.6W	
工作温度	-25℃~+60℃	
典型精度	±10% FS (@365nm,60%RH,25℃)	
紫外线强度量程	0~15 mW/ cm ²	
测量波长范围	波长 290-390 nm	
线性度	≤±1%	
年稳定度	≤±3%	
响应时间	0.2s	
输出信号	电流输出	4mA~20mA
	电压输出	0~5V/0~10V
负载能力	电流输出	带负载能力≥600Ω
	电压输出	输出电阻≤250Ω

以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。尽管本产品具有很高的可靠性,但我们建议在使用前检查设备功能是否正常,参数是否达标,确保不影响现场使用。

1.3 产品选型

RS-					公司代号
	UV-				紫外线变送器
		I20-			4~20mA 电流输出
		V05-			0~5V 电压输出
		V10-			0~10V 电压输出
			AL		铝制外壳

2.设备安装

2.1 安装前检查


- 变送器设备 1 台
- 保修卡、合格证等

2.2 安装方式

1. 使用螺丝透过传感器上的安装孔，将传感器固定在安装托片上
2. 确保设备与地面平行（可调节手拧螺丝并查看水平泡状态来确定是否平行）
3. 安装完成后，摘除保护盖




2.3 设备尺寸（单位：mm）

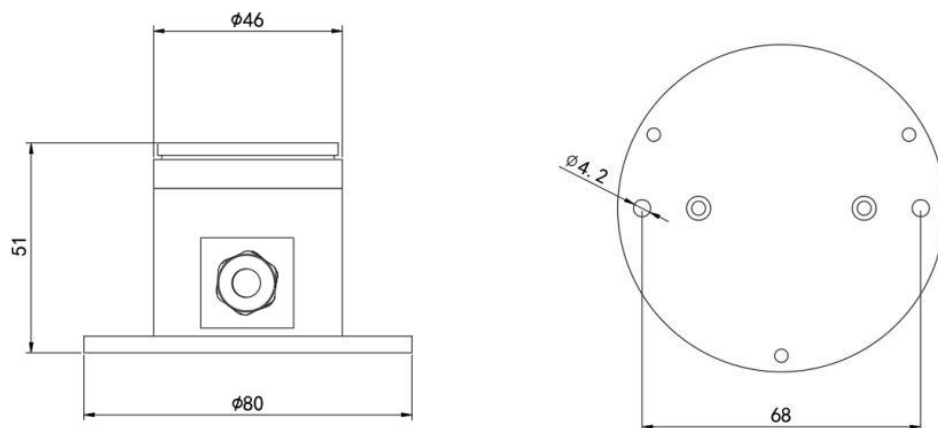


2.4 接线

	线色	说明
电 源	棕色	电源正 (10~30V DC)
	黑色	电源负
通 信	蓝色	信号正
	黄 (绿) 色	信号负

3. 接线方式举例

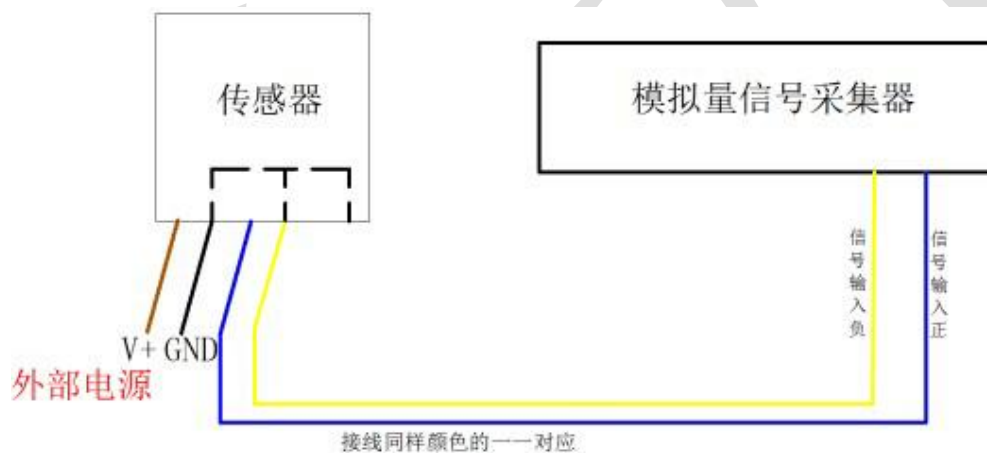

四线制接法示意图

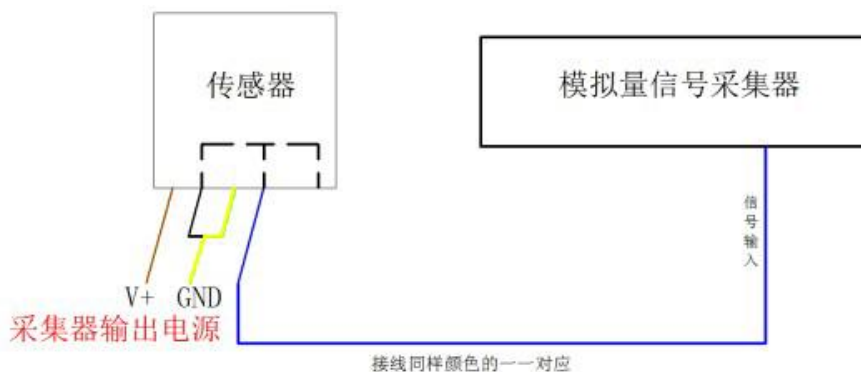

三线制接法示意图



4.计算方法

4.1 电流型输出信号转换计算

紫外线强度量程 $0\sim 15\text{ mW/cm}^2$ ， $4\sim 20\text{mA}$ 输出，当输出信号为 12mA 时，计算当前紫外线强度值。此紫外线强度量程的跨度为 15 mW/cm^2 ，用 16mA 电流信号来表达， $15/16=0.9375$ ，即电流 1mA 代表紫外线强度变化 0.9375 mW/cm^2 ，测量值 $12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$ ， $8*0.9375=7.5\text{ mW/cm}^2$ ，当前紫外线强度 7.5 mW/cm^2 。

4.2 电压型输出信号转换计算

紫外线强度量程 $0\sim 15\text{ mW/cm}^2$ ， $0\sim 10\text{V}$ 输出，当输出信号为 5V 时，计算当前紫外线强度值。紫外线强度量程的跨度为 $0\sim 15\text{ mW/cm}^2$ ，用 10V 电压信号来表达， $15/10=1.5$ ，即电压 1V 代表紫外线强度变化 1.5 mW/cm^2 ，测量值 $5\text{V}-0\text{V}=5\text{V}$ ， $5*1.5=7.5\text{ mW/cm}^2$ ，当前紫外线强度为 7.5 mW/cm^2 。

5.常见问题及解决办法

无输出或输出错误

可能的原因：

- 1)量程对应错误导致 PLC 计算错误。
- 2)接线方式不对或者接线顺序错误。
- 3)供电电压不对（针对 $0\sim 10\text{V}$ 型均为 24V 供电）。
- 4)变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。
- 5) PLC 采集口损坏。
- 6)设备损坏。

6.注意事项

1) 警告：人身伤害风险。本设备严禁用作安全装置或紧急停止装置，亦不得用于可能因设备故障导致人身伤害的其他用途。使用限制：仅限按预期授权用途使用。安装、操作或维修前必须查阅技术手册。未遵守上述指引可能导致死亡或严重伤害。



7. 质保声明

保修期限自购买日起 12 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质渗入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。

8..联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编： 250101

电话： 400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)

欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

9.文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 规范设备典型精度描述